

Surgical Technique Brochure

QuickFit PK

Promedon
Sports Medicine

QuickFit PK

Fijaciones seguras, máxima estabilidad.


El ancla impactada **Quick**Fit PK **de 2,9 mm** está diseñada para lograr una rápida fijación del tejido en reparaciones sin nudos.



Zona de impacto de alta resistencia con clip de seguridad de desacople rápido.

Zona de sujeción amplia para mayor precisión y control durante la implantación.

Zona de retención de suturas para bloquear la tensión de la sutura en la etapa de preimplantación.

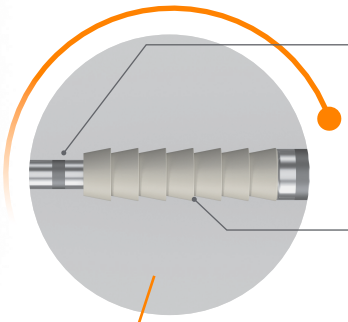

Implantación precisa

Sus marcas láser permiten identificar la profundidad de implantación adecuada.

Espigas pronunciadas

Garantizan un bloqueo seguro del implante en el tejido óseo.

Ojal distal para un correcto aseguramiento de sutura.

Técnica Quirúrgica
Step by step



Utilizando el dispositivo **LassoFix**, pase una sutura tipo cinta TapeFit 1,5 mm a través de la zona donde se realizará la reparación.

NOTA: *se recomienda pasar la sutura en configuración de "cincha" para lograr una sujeción más robusta.*



Fije la guía de implantación de 3,2 mm próxima a la zona de reparación e introduzca la **broca para QuickFit PK de 2,9 mm** para realizar el orificio de inserción. Luego retire la broca y la guía.

NOTA: avance la broca hasta que el anillo metálico haga tope con el mango de la guía.



A través del enhebrador, cargue los extremos de la sutura por el ojal externo del ancla.



Oriente el dispositivo de inserción hacia el orificio, utilizando la sutura previamente pasada a través del labrum como guía de referencia.



Inserte el dispositivo hasta posicionarse antes de la marca láser distal y traccione levemente las suturas hasta obtener la tensión deseada.

IMPORTANTE: *hasta este paso es posible regular la tensión, antes de que el* ancla haga tope en el taco óseo.



Una vez alcanzada la tensión deseada, fije los extremos libres de la sutura a las aletas del mango.



Impacte el dispositivo de inserción hasta llegar a la marca láser transversal del capilar.



Retire el clip de seguridad.



Continúe impactando hasta que el gatillo descienda por completo y llegue a la marca láser proximal, lo que asegura la correcta inserción del ancla.

NOTA: *si el gatillo desciende, pero aún no se alcanza la marca láser, continúe impactando hasta llegar a la misma.*



Libere los extremos de la sutura fijados en las aletas del dispositivo de inserción.



Retire el dispositivo de inserción, girándolo en sentido antihorario entre 8 y 10 vueltas, para desacoplar el ojal.



Para finalizar la reparación, corte los remanentes de sutura con la pinza corta sutura punta tijera.

ANCLAJE OPTIMIZADO

- Fijación segura.
- Diseño ergonómico.
- Fácil y rápida inserción.
- Mejora la interacción con el tejido blando gracias a su compatibilidad con sutura tipo cinta de 1,5 mm.



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

IMPLANTE

Código	Descripción
FG-AN022029	Ancla QuickFit PK de 2,9 mm x 15,5 mm.

PRODUCTOS ASOCIADOS

Código	Descripción
FG-SU711115	Sutura TapeFit, tipo cinta, de 1,5 mm de UHMWPE, azul, de 38'' (96 cm) de longitud.
FG-CN910670	Cánula rígida roscada de 6 mm x 70 mm con obturador descartable.
FG-CN910690	Cánula rígida roscada de 6 mm x 90 mm con obturador descartable.
FG-CN910870	Cánula rígida roscada de 8 mm x 70 mm con obturador descartable.
FG-CN910890	Cánula rígida roscada de 8 mm x 90 mm con obturador descartable.

INSTRUMENTAL ASOCIADO

Código	Descripción
FG-IN082029	Broca para QuickFit de 2,9 mm.
FG-IN013000	Guía de implantación de 3,2 mm.

BRO-0018 (01) / SEP-2026

Indicación de uso: Las anclas de PEEK se indican para la fijación de tejidos blandos al hueso.
En Ecuador: REGISTRO SANITARIO No. 16687-DME-0524.

La disponibilidad de los productos puede variar según el mercado y las aprobaciones regulatorias locales. Consulte con su representante para más información.

Promedon
Sports Medicine